SAKAImed

立位移動補助具

アクティーモ NR

NR-2014

取 扱 説 明 書

ご使用になる前に ····· 3
- **安全上のご注意** ····· 3
- **各部の名称** ····· 6
- **始業点検について** ····· 7
- **静電気について** ····· 7

使用方法 ····· 8
- **身体固定ベルトの調節** ····· 8
- **移乗** ····· 9

日常のお手入れ ····· 13
- **清掃** ····· 13
- **消毒** ····· 13

機器について ····· 14
- **保守・点検について** ····· 14
- **保証とアフターサービス** ····· 14
- **仕様** ····· 15

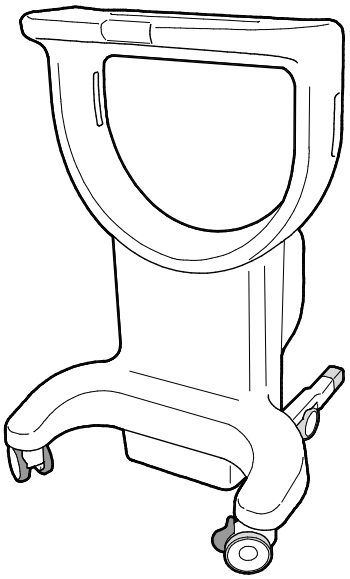

●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●「取扱説明書」は
・１部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
・１部を保存用として、大切に保管してください。

06-083①R8

用 途

本製品は、立位姿勢を保つことで、急性期や早期離床のための立位・移動リハビリテーションが行える立位移動補助具です。

特 長

● 立位での移動が可能

健側の機能を活用して移動ができます。
脳卒中後早期の方でも、下肢・体幹を支持、保持しながら安全に立位姿勢が保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。

● さまざまな場面で利用が可能

残存機能を活用して移動や移乗を行うことで、介助の負担を軽減します。
障害者用トイレでは、便座前方に直接アプローチができるので、片マヒの向きにかかわらず、安全な介助ができます。
また、スタンディングテーブルとして、立位でのトレーニングもできます。

● 姿勢の修正が可能

大きな開口部により、前方・後方のどちらからでも立位姿勢を正すことができます。

ご使用になる前に

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

表示について

危険や損害の程度を以下に区分し、表示しています。

⚠ 危険	取り扱いを誤ると、**「死亡または重傷を負うことに至る」**ことを示しています。
⚠ 警告	取り扱いを誤ると、**「死亡または重傷を負う可能性が想定される」**ことを示しています。
⚠ 注意	取り扱いを誤ると、**「傷害または物的損害の発生が想定される」**ことを示しています。

絵表示の意味

⃠ 禁止	行為を禁止することを示した表示です。
❗ 強制	必ず実行していただくことを示した表示です。

ご使用になる前に／安全上のご注意

使用について

⚠警告

運動に適さない靴で使用しない
かかとの高い靴や、サンダル・スリッパなどの滑りやすい履物では使用しないでください。

2 人以上で同時に使用しない
故障やけがの原因となります。

医師や指導者の指示に従って使用する
事故やけがをする恐れがあります。

屋外で使用しない
事故やけがをする恐れがあります。

段差がある場所で使用しない
事故やけがをする恐れがあります。

傾斜があるところ、滑りやすい面、やわらかい面では使用しない
乾いた平らな面で本製品を使用してください。滑りやすい面、またはじゅうたん等のやわらかい面では不安定になり、事故やけがをする恐れがあります。

ほつれたり、傷ついているベルトは使用しない
ベルトが切れて転倒し、けがをする恐れがあります。

故障したら、ただちに使用を中止する
そのまま使用すると、けがをする恐れがあります。

ご使用になる前に／安全上のご注意

使用について

⚠注意

機器を改造しない

故障やけがの原因となります。

用途以外の目的に使用しない

故障やけがの原因となります。

最大使用者体重は 100kg です

作動不良および故障の原因となります。

使用者の適応身長は 145～180cm です

適正な立位がとれず、事故やけがをする恐れがあります。

使用時は必ず身体固定ベルトで身体を固定する

事故やけがをする恐れがあります。

ガタつき等がないか確認する

使用前に各部を点検し、ガタつき等がないか確認してください。けがの原因となります。

ご使用になる前に

各部の名称

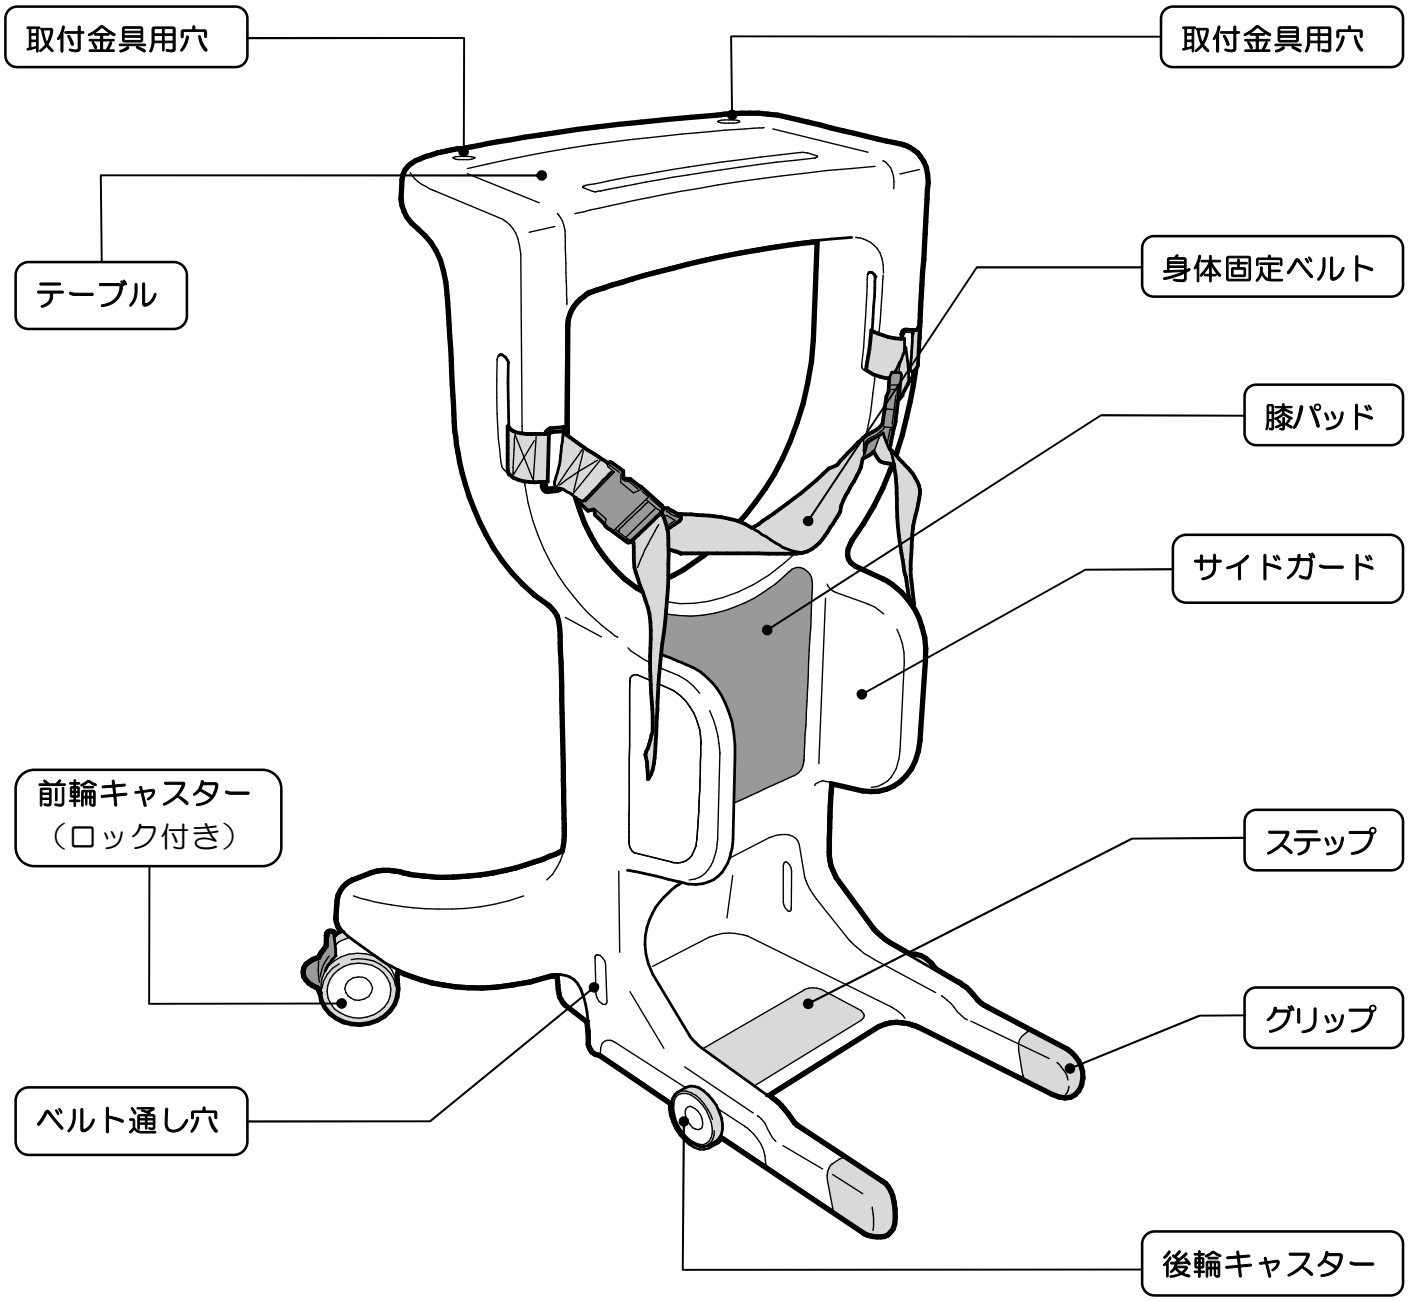

参考

- テーブルは傾斜がついているので転がりやすいものは置かないでください。
- 移動の際に下腿が不安定な場合は、ベルト通し穴に市販のベルト等を通すことで、足の跳ね上がりの防止や足関節位置の保持ができます。

ご使用になる前に

始業点検について

ご使用前に**始業点検項目**に基づき、始業点検を実施してください。

点検の際は、本ページをコピーしてご使用ください

始業点検項目：アクティーモ NR　　点検日　　年　　月　　日

項目	点検内容	点検方法	チェック	備考
①	機器の汚れ、損傷	目視	□ OK・□ NG	
②	ガタつきや歪みの有無	目視	□ OK・□ NG	
③	キャスター作動・ロック	目視・作動確認	□ OK・□ NG	
④	身体固定ベルト	目視・作動確認	□ OK・□ NG	

これ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになっていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所にご連絡ください。
なお、故障中は故障した機器を誤って使用しないように、周囲の方が分かるように表示（故障中の貼り紙等）をお貼りください。

静電気について

空気が乾燥している冬場など、本製品に触れるときに静電気を感じる場合があります。静電気が気になる場合は、できるだけ静電気を除去してご使用ください。

参考

- 本製品に帯電した静電気の除去方法
  タオル等で気になる箇所を水拭きしてください。市販の静電気除去ブラシ等でも除電できます。ただし、いずれも効果は一時的なものです。
- 市販の衣類用静電気防止スプレーを衣類に噴きつけると静電気の帯電を低減できます。
- 室内を加湿することで静電気を低減できます。
- 人体に帯電した静電気の除去方法（（独）労働安全衛生総合研究所ホームページより抜粋）
  革製の財布や手袋があれば，それを手に持ってドアノブなどの金属体に触れれば、ショックを感じることなく静電気を逃がすことができます。革製品がなかったらコンクリートや木製の壁に数秒間手を触れてもよいでしょう。

使用方法

身体固定ベルトの調節

使用者の体格に応じて身体固定ベルトの長さを調節します。
ベルトの端がアジャスターを通るようにしてください。

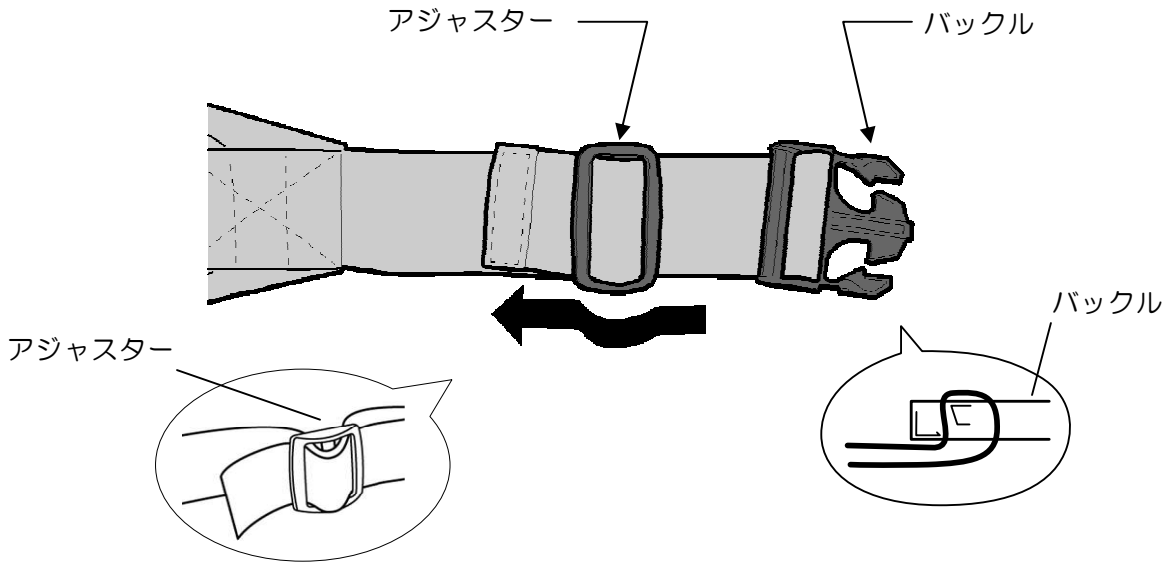

左右の長さを調節したら、ベルトを引っ張って抜けないことを確認してください。

使用方法

移乗

1. 本製品を使用者の正面に置き、前輪キャスターをロックします。

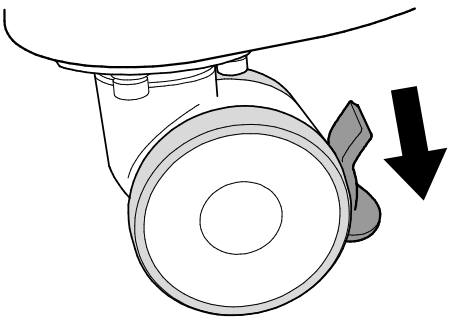

キャスターロック

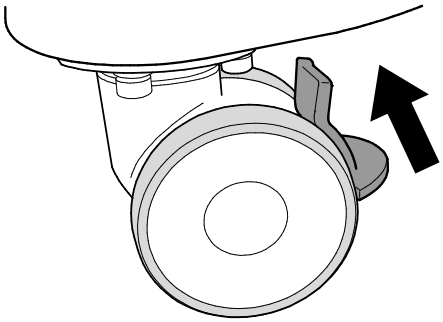

ロック解除

2. 使用者の両足をステップに乗せ、テーブルにつかまらせます。

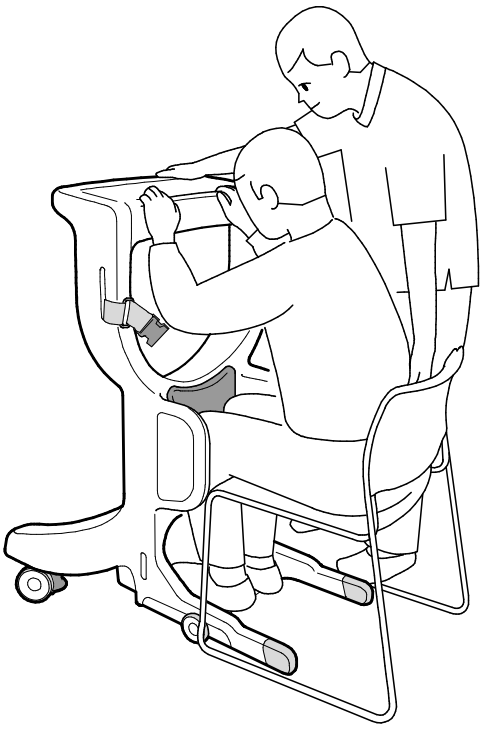

使用方法

3. 指導者が介助しながら、使用者を起立させます。

立ち上がるときにバランスを崩さないよう、注意してください。

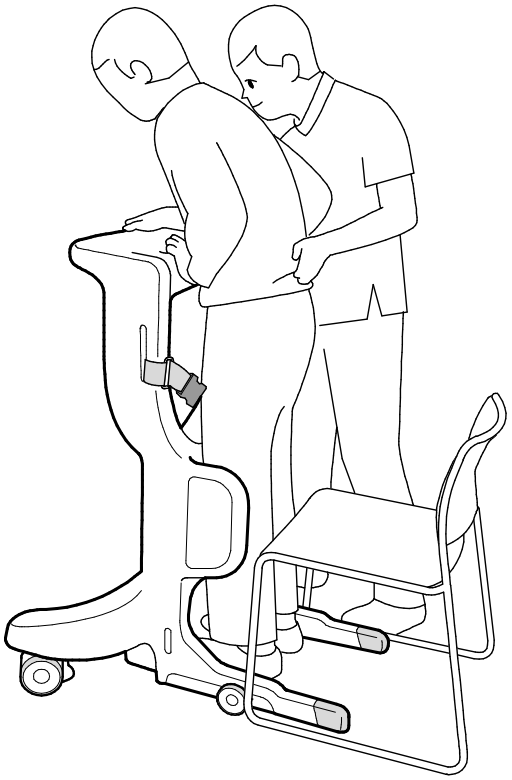

4. 身体固定ベルトのバックルを留めます。

左右のバックルが確実にはまっていることを確認します。

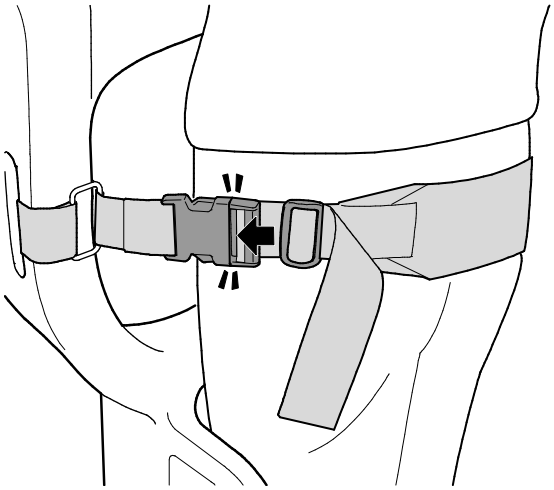

使用方法

5. 使用者の骨盤の位置にベルトがあたるよう、高さと長さを調節します。

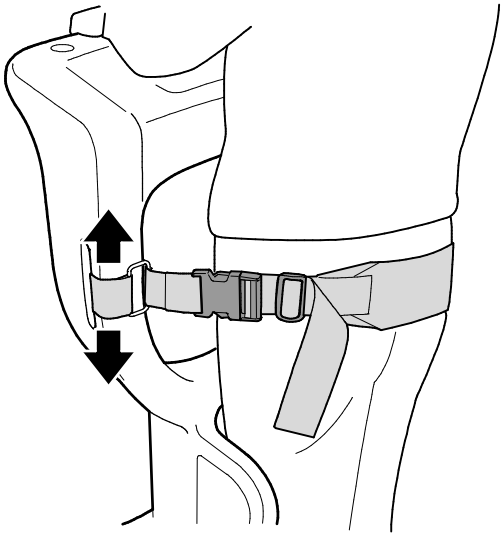

6. 使用者の姿勢が崩れている場合は修正します。

足がステップから大きくはみ出していないか、膝がパッドに接しているか、骨盤とベルトの位置がずれていないかを確認してください。

使用方法

7. キャスターのロックを解除し、患側の足をステップに乗せたまま、健側の足で移動します。

走行経路に障害物がないことを確認してください。
走行は医師または指導者の看視のもとで行ってください。

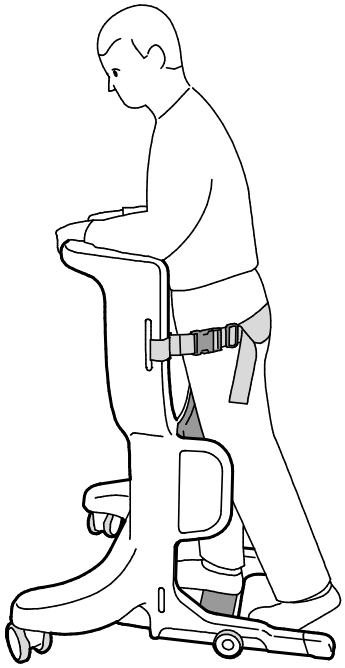

自力で移動できない使用者の場合は、指導者が補助しながら移動させます。

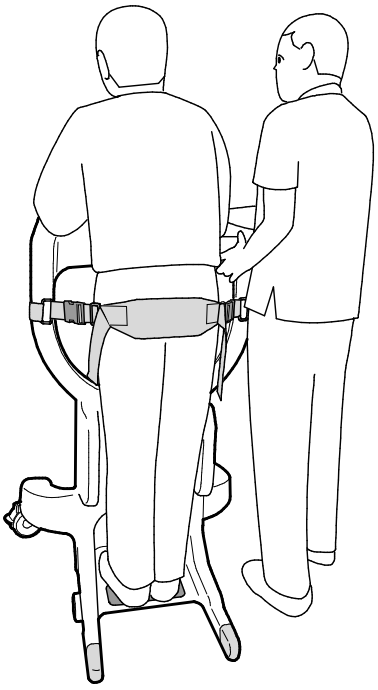

⚠ **警告**
- **段差・階段や傾斜があるところでは使用しない**
- **必ず医師または指導者の看視のもとで使用し、転倒に注意する**
- **浴室内や濡れた場所で使用しない**

日常のお手入れ

清掃

- 汗や汚れはすぐに乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤、弱アルカリ性洗剤、またはアルカリ性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。その後、乾拭きしてください。
- 膝パッドに、アルコール、ベンジン、シンナー等の溶剤を使用しないでください。色あせや変形の原因になります。

消毒

消毒をする際は、以下のいずれかの消毒剤を使用し、消毒剤の用法・用量は各消毒剤の取扱説明書に準じてください。（本製品の消毒は病室、家具、器具等の消毒と同等です）なお、消毒剤は直接本製品にかけず、ガーゼ等の柔らかい布に含ませて拭いてください。

- クロルヘキシジン消毒
- 逆性石鹸消毒
- 塩素系薬剤消毒

機器について

保守・点検について

- 本製品をご使用する際は、機器の管理者の方が P.7 の点検項目に基づき、必ず始業点検を実施してください。
- 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、正常な状態か十分に点検してください。
- **点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。**
- 清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

保証とアフターサービス

保証書と保証期間

- 保証書（別添）は再発行致しませんので紛失されないよう大切に保管してください。
  保証書がないと保証期間中でも有償修理とさせていただく場合があります。
- 保証期間は 1 年です。保証の規定につきましては、保証書をご覧ください。

修理をご依頼いただく場合

- 修理をご依頼いただく場合は、下記のことをお知らせください。

  機種名　　：　*NR-2014*
  お買い上げ：　　年　　月　　日
  故障状況（できるだけ詳細に）
  住所、氏名、電話番号
- メーカーより指示のあるとき以外は、機器を分解しないでください。

耐用期間

5 年：正常な使用状態で、適正な維持管理のもとに使用された場合

機器について

損耗品（使用により、摩耗･劣化･変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- 正常な使用において、交換の目安が約 2 年のもの
  - 身体固定ベルト、グリップ、ステップ部のシート
- 正常な使用において、交換の目安が約 3 年のもの
  - キャスター、膝パッド
- 損耗品の交換時期になりましたら、弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

保守用性能部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

仕様

型式		NR-2014
外形寸法		長さ 825×幅 730×高さ 1110㎜
質量		約 20 kg
最大使用者体重		100 kg
適応身長		145～180cm
キャスター		φ100（前輪）、φ75（後輪）
材質	本体	プラスチック（PE）
	膝パッド	プラスチック（PU）
	ベース	ステンレス
付属品		身体固定ベルト

注）都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。